

A


Leiterplatte: 8290678-05,ST

- Abgleich und Pruefung nach FKV durchgefuehrt
- Schutzlackierung nicht durchgefuehrt
- Ausfuehrung nach DWN 3141, Klasse 2

B

alte Sachnummer ueberklebt mit:  
8309136  
Schild beschriftet mit:  
2M22382-00  
Serial-Nr. nach DMTN0419-A

C




D


hierzu: SPlan 8200773-17  
FKV K02093

Traceable: DMTN0418-P1

ST2M22382



E

scale	general tolerances	material		safety class	
				<s>	0
				<m>	0
field reserved		revision text			
filing dept. 2950	responsible dept. 5511	author 15.08.2000 Stickel	approved 15.08.2000 Kleinert	(2000 / CC / 336)	
				contract n	
type drawing	language de	title Best. LP Analog Thermon			
	replacement for 8290678-05	number 2M22382			
creating system CADRA	release status RELEASED	revision index 00	occures 00	page/of 01/01	Dräger Medizintechnik GmbH D-23542 Lübeck

F

size A4

Schutz nach DIN 34 beansprucht.  
Use of the document / contents is forbidden  
without express authorisation. All rights reserved.  
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck


A

Leiterplatte: 8290680-04,ST  
umgeruestet zu 2M22407-00  
nach Umruestanweisung 2M22388

B

alte Sachnummer ueberklebt mit:  
8309136  
Schild beschriftet mit:  
2M22407-00  
Serial-Nr. nach DMTN0419-A

C

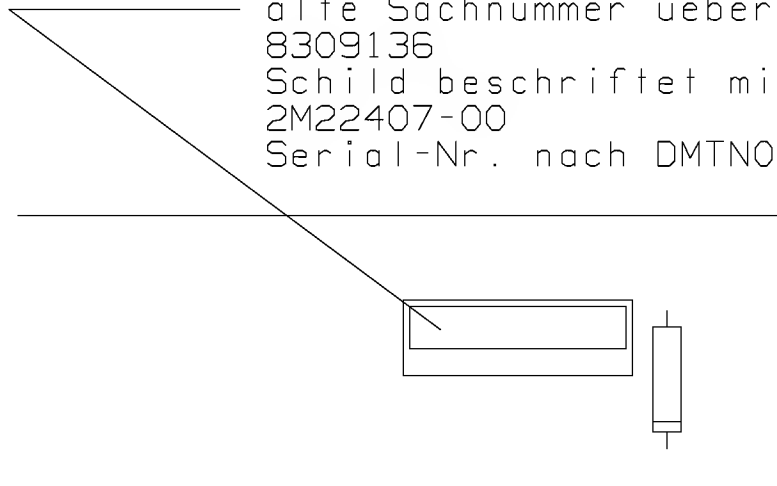


D

hierzu: SPlan 8200773-17  
FKV K02093

ST2M22407

Traceable: DMTN0418-P1



E

scale		general tolerances		material		safety class	
						<s> 0 <m> 0	
field reserved				revision text			
filing dept. 2950		responsible dept. 5511		author 02.08.2000 Stickel		approved 02.08.2000 Kleinert	
						(2000 / CC / 336) contract n	
type drawing		language de		title Best. LP Analog Thermon			
replacement for 8290680-04		number 2M22407		revision index 00		occures 00	
creating system CADRA		release status RELEASED		page/of 01/01		Dräger Medizintechnik GmbH D-23542 Lübeck	

F

size A4

Schutz nach DIN 34 beansprucht.  
Use of the document / contents is forbidden  
without express authorisation. All rights reserved.  
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck


A

Leiterplatte: 8290678-03, ST  
umgeruestet zu 2M22406-00  
nach Umruestanweisung 2M22388

B

alte Sachnummer ueberklebt mit:  
8309136  
Schild beschriftet mit:  
2M22406-00  
Serial-Nr. nach DMTN0419-A


C



D

hierzu: SPlan 2M22392-00  
FKV K02093

ST2M22406-00



E

<i>scale</i>		<i>general tolerances</i>		<i>material</i>		<i>safety class</i>	
						<i>&lt;s&gt;</i> 0 <i>&lt;m&gt;</i> 0	
<i>field reserved</i>				<i>revision text</i>			
<i>filing dept.</i> 2950		<i>responsible dept.</i> 5511		<i>author</i> 02.08.2000 Stickel		<i>approved</i> 02.08.2000 Kleinert	
						<i>contract</i> n	
<i>type</i> drawing		<i>language</i> de		<i>title</i> LP Analog, Therman OT			
		<i>replacement for</i> 8290678-03		<i>number</i> 2M22406			
<i>creating system</i> CADRA		<i>release status</i> RELEASED		<i>revision index</i> 00		<i>occures</i> 00	
				<i>page/of</i> 01/01			

Dräger  
Dräger Medizintechnik  
GmbH  
D-23542 Lübeck

size A4


A

Leiterplatte: 8290678-02,ST  
umgeruestet zu 2M22405-00  
nach Umruestanweisung 2M22388

B

alte Sachnummer ueberklebt mit:  
8309136  
Schild beschriftet mit:  
2M22405-00  
Serial-Nr. nach DMTN0419-A


C

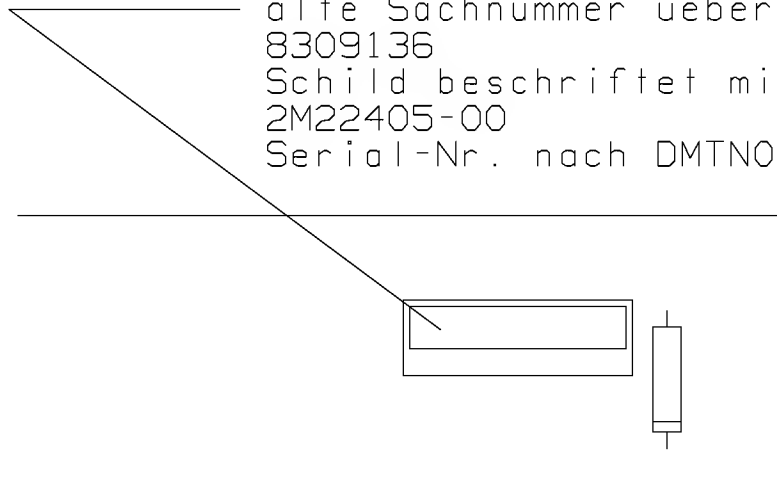


D

hierzu: SPlan 2M22392-00  
FKV K02093

ST2M22405



E

<i>scale</i>		<i>general tolerances</i>		<i>material</i>		<i>safety class</i>	
						<i>&lt;s&gt;</i> 0 <i>&lt;m&gt;</i> 0	
<i>field reserved</i>				<i>revision text</i>			
<i>filing dept.</i> 2950		<i>responsible dept.</i> 5511		<i>author</i> 02.08.2000 Stickel		<i>approved</i> 02.08.2000 Kleinert	
				<i>date</i> <i>name</i>		<i>contract</i> n	
<i>type</i> drawing		<i>language</i> de		<i>title</i> LP Analog, Therman OT		(2000 / CC / 336)	
		<i>replacement for</i> 8290678-02		<i>number</i> 2M22405			
<i>creating system</i> CADRA		<i>release status</i> RELEASED		<i>revision index</i> 00		<i>occures</i> 00	
				<i>page/of</i> 01/01		Dräger Medizintechnik GmbH D-23542 Lübeck	

F

size A4


A

Leiterplatte: 8290678-01,ST  
umgeruestet zu 2M22404-00  
nach Umruestanweisung 2M22388

B

alte Sachnummer ueberklebt mit:  
8309136  
Schild beschriftet mit:  
2M22404-00  
Serial-Nr. nach DMTN0419-A


C

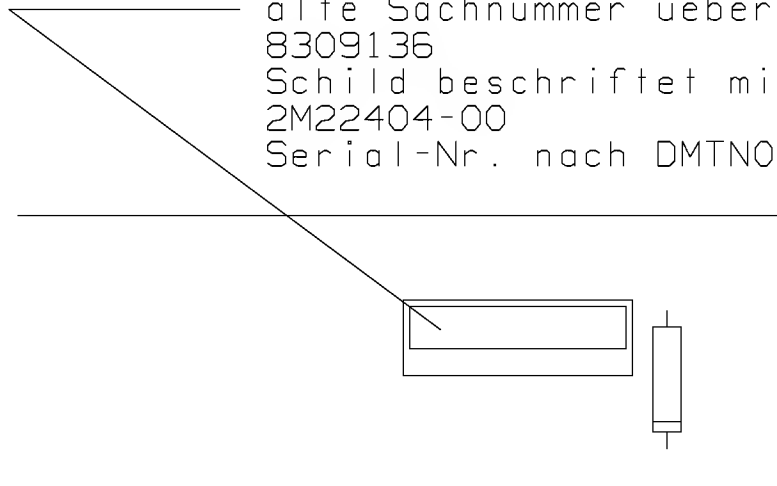


D

hierzu: SPlan 2M 22 392-00  
FKV K02093

ST2M22404



E

<i>scale</i>		<i>general tolerances</i>		<i>material</i>		<i>safety class</i>	
						<i>&lt;s&gt;</i> 0 <i>&lt;m&gt;</i> 0	
<i>field reserved</i>				<i>revision text</i>			
<i>filing dept.</i> 2950		<i>responsible dept.</i> 5511		<i>author</i> 02.08.2000 Stickel		<i>approved</i> 02.08.2000 Kleinert	
						<i>contract</i> n	
<i>type</i> drawing		<i>language</i> de		<i>title</i> LP Analog, Therman OT		(2000 / CC / 336)	
		<i>replacement for</i> 8290678-01		<i>number</i> 2M22404			
<i>creating system</i> CADRA		<i>release status</i> RELEASED		<i>revision index</i> 00		<i>occures</i> 00	
				<i>page/of</i> 01/01		Dräger Medizintechnik GmbH D-23542 Lübeck	

F

size A4

8301853 (7/25) um 20° bis 30°  
in Richtung R22 gebogen  
Pin3 entfernt

8301853 (4/25) (2x)  
1814508 (2x)

1329987 (2x)  
D04766 (2x)  
1334913 (2x)  
8303296 gekennzeichnet mit 2 mm Schrifthöhe :  
8290678-05  
Serial-Nr. nach DMTN019-A  
8301853 (13/25) (2x)

8200771

8302725

- Ausführung nach DWN 3141, Klasse 2  
- C1 und C12 auf LP liegend eingelötet  
oder zur Seite gebogen

hierzu: Stückliste ST8290678

R124 auf RM 7,5  
gebogen

1205633 (0,02lg)  
(Schrumpfh. 12-4X sw-8304999)  
G1 mit Heisskleber fixiert

8301566 ⑤

1338935 (2x)

1809865 (2x)


1826131

mit Heisskleber fixiert

8300286 (9x)

-OA-	-	-OB-	-	-OC-	-
Werkstoff					
5		6x		C13 raus Text geändert, Fassung neu, N6 geä. R111, R112 entfernt, Menge geä. (00/cc/321)	
Änderungen					
Maßstab	Allgemein- toleranzen	Abteilung	2000 Tag	Name	
2:1	-	MT	Beart. 12.07	Faber	
			Gepf. 1.1	Kleinert	
Benennung			LP		Zeichnungs-Nr.
			Analog, Theron OT		8290678
			(Thermomonitor)		Blatt 1 von 9 Bl.
HPDC-6			Ersetzt für 8290678*3*		Ersetzt durch


Dräger

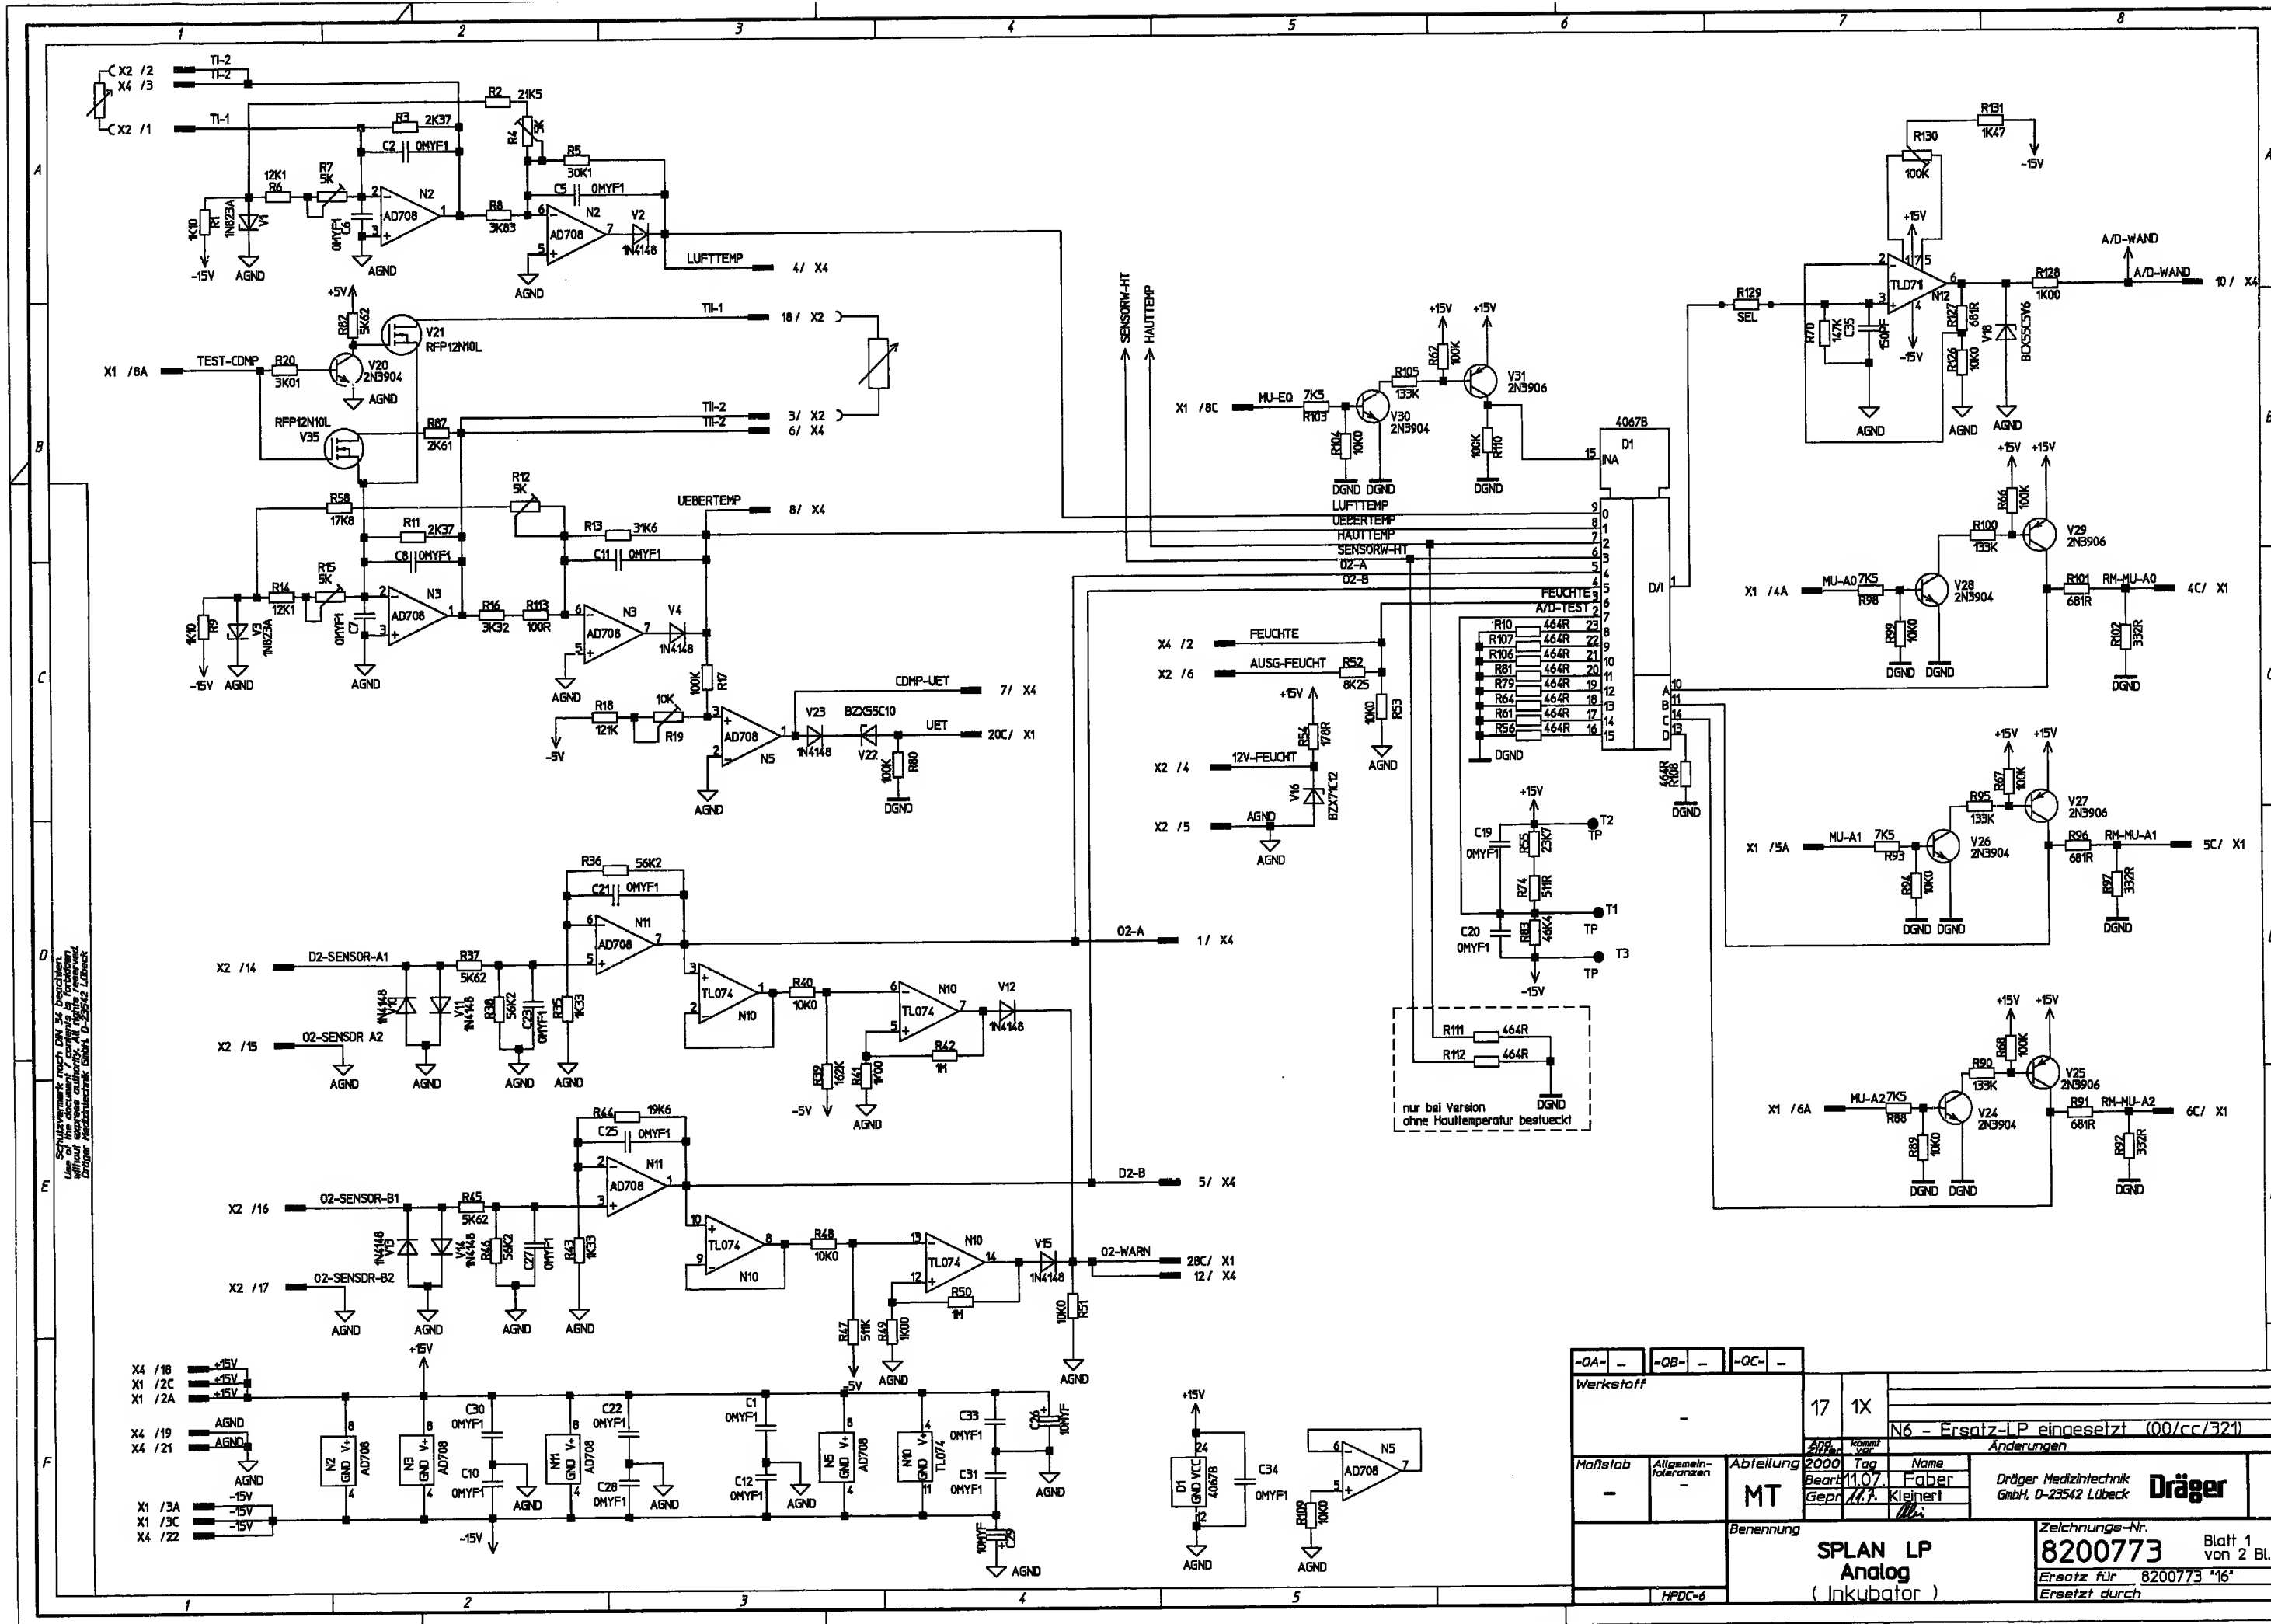

Schutzrecht nach DIN 34 beachten.  
 Use of this document is permitted for technical  
 input without restriction. DIN 34, D-5342 Löhndorf

-QA- - -QB- - -QC- -		17 1X		N6 - Ersatz-LP eingesetzt (00/cc/321)	
Werkstoff		APR 11 1977		Änderungen	
Maßstab	Allgemein-toleranzen	Abteilung	2000 Tag	Name	Dräger
		MT		Faber	
Benennung		SPLAN LP Analog (Incubator)		Zeichnungs-Nr. 8200773 Blatt 1 von 2 Bl.	
HPDC-6				Ersatz für 8200773 "16"	
				Ersetzt durch	

Schaltplan nach DIN 34 beschreiben.  
Use of the document / copy right is forbidden.  
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

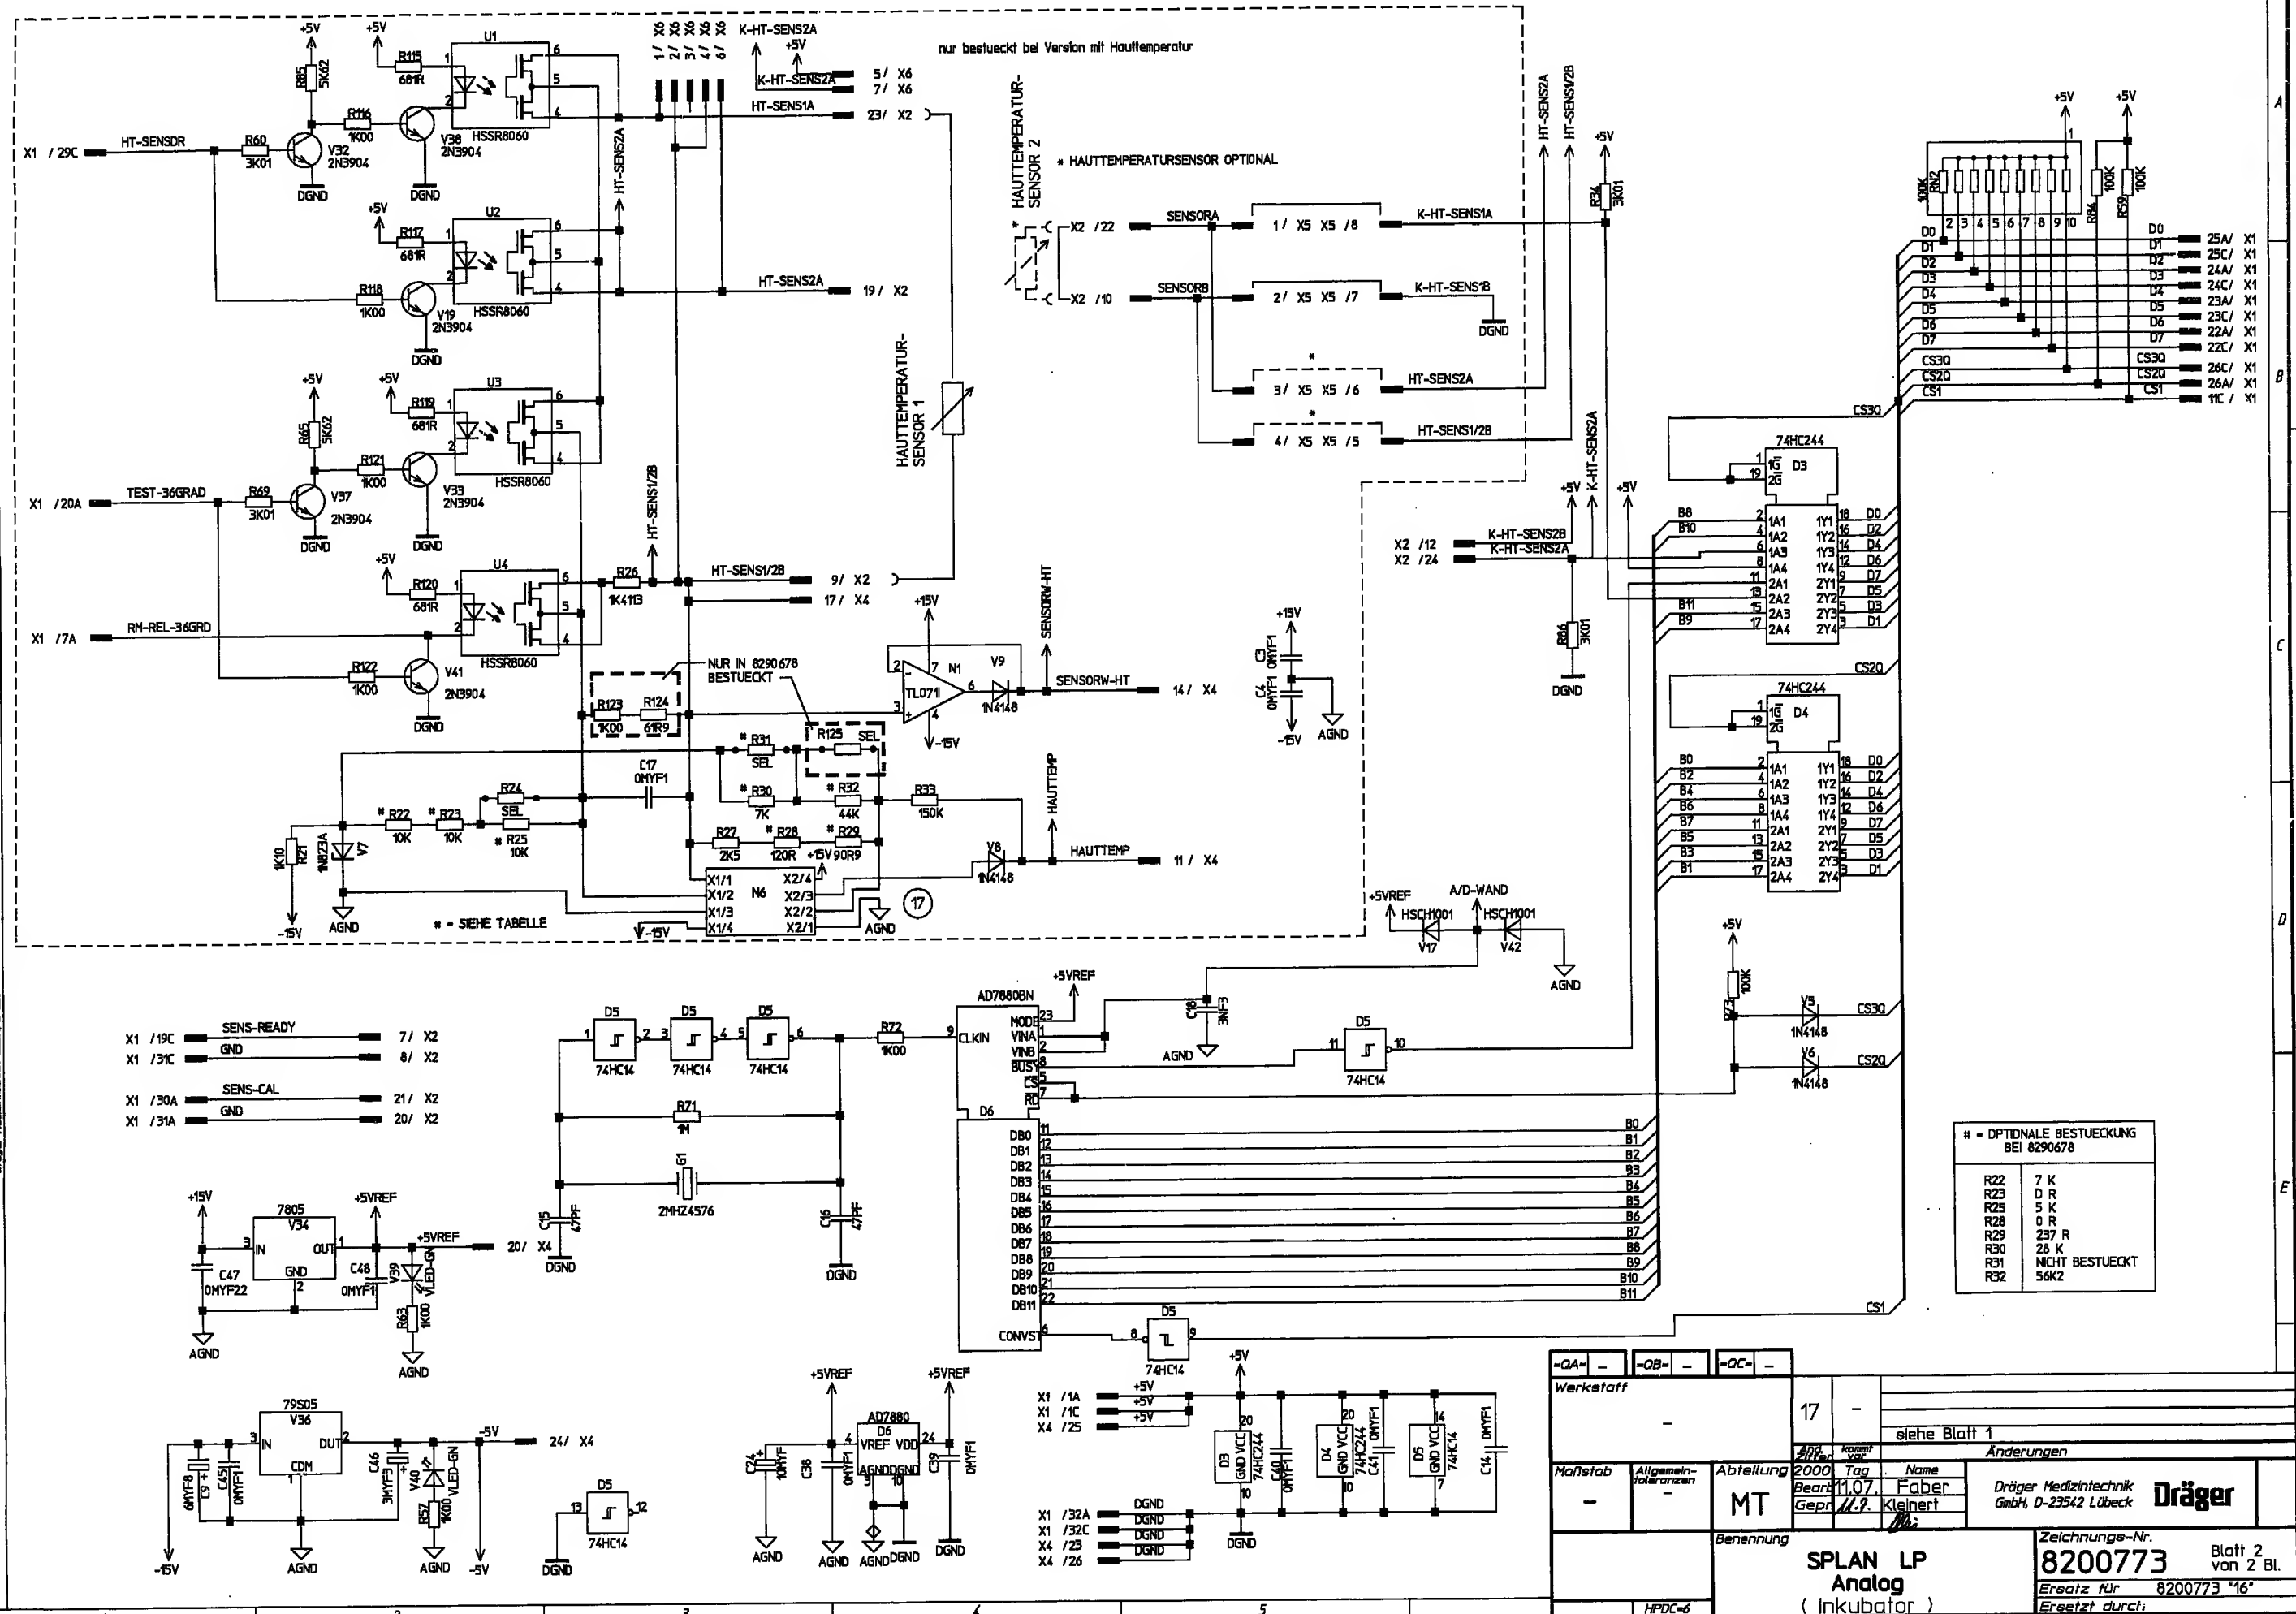

# = OPTIONALE BESTUECKUNG  
BEI 8290678

R22	7 K
R23	D R
R25	5 K
R28	0 R
R29	237 R
R30	28 K
R31	NICHT BESTUECKT
R32	56K2

-QA-		-QB-		-QC-	
Werkstoff					
17					
siehe Blatt 1					
Änderungen					
Maßstab	Allgemein- toleranzen	Abteilung	2000	Tag	Name
-	-	MT	11.07.	11.07.	Faber
Benennung		SPLAN LP Analog ( Inkubator )		Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck	
HPDC-6		Zeichnungs-Nr. 8200773		Blatt 2 von 2 Bl.	
		Ersatz für 8200773 "16"		Ersetzt durch:	